



## Drill Sequence

Ø2.5

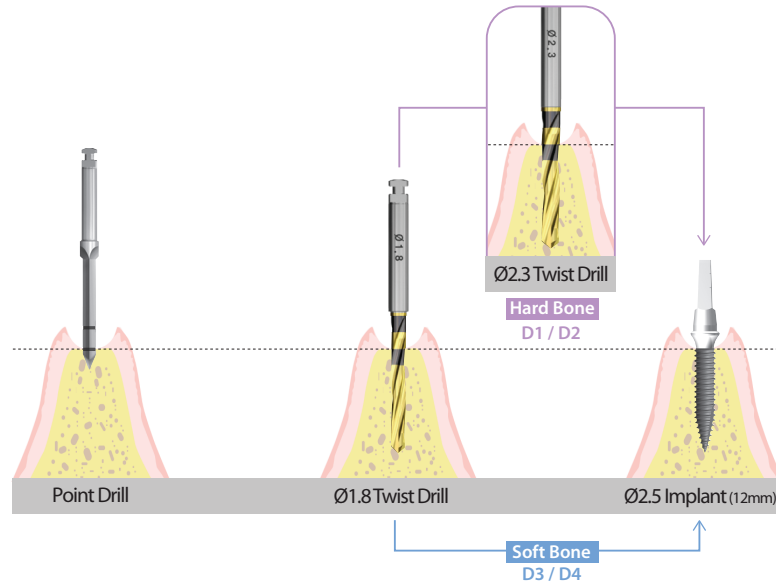

Ø3.0

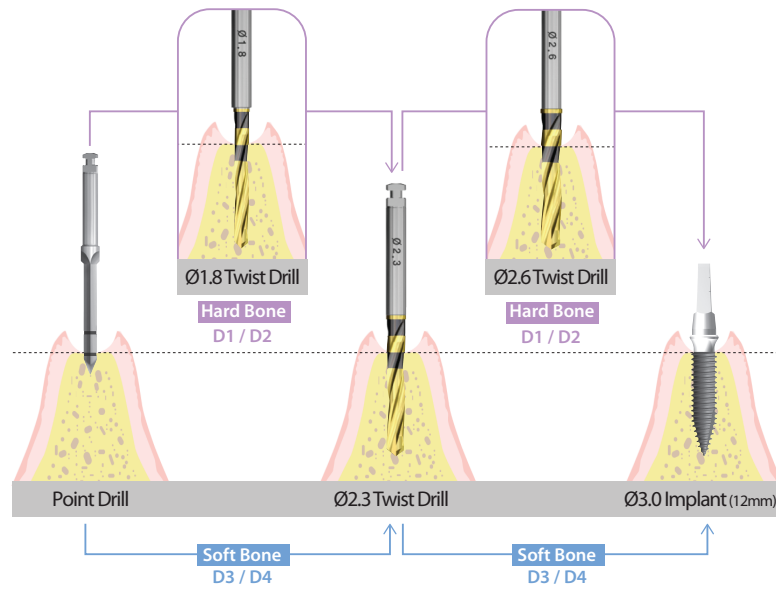

※ 골질 D4 Bone에서는 Drilling 깊이를 조절하여 Implant가 Self Tapping하면서 식립될 수 있도록 함